




Protocoles analytiques TEMPO®



PIONEERING DIAGNOSTICS



Protocoles analytiques TEMPO®

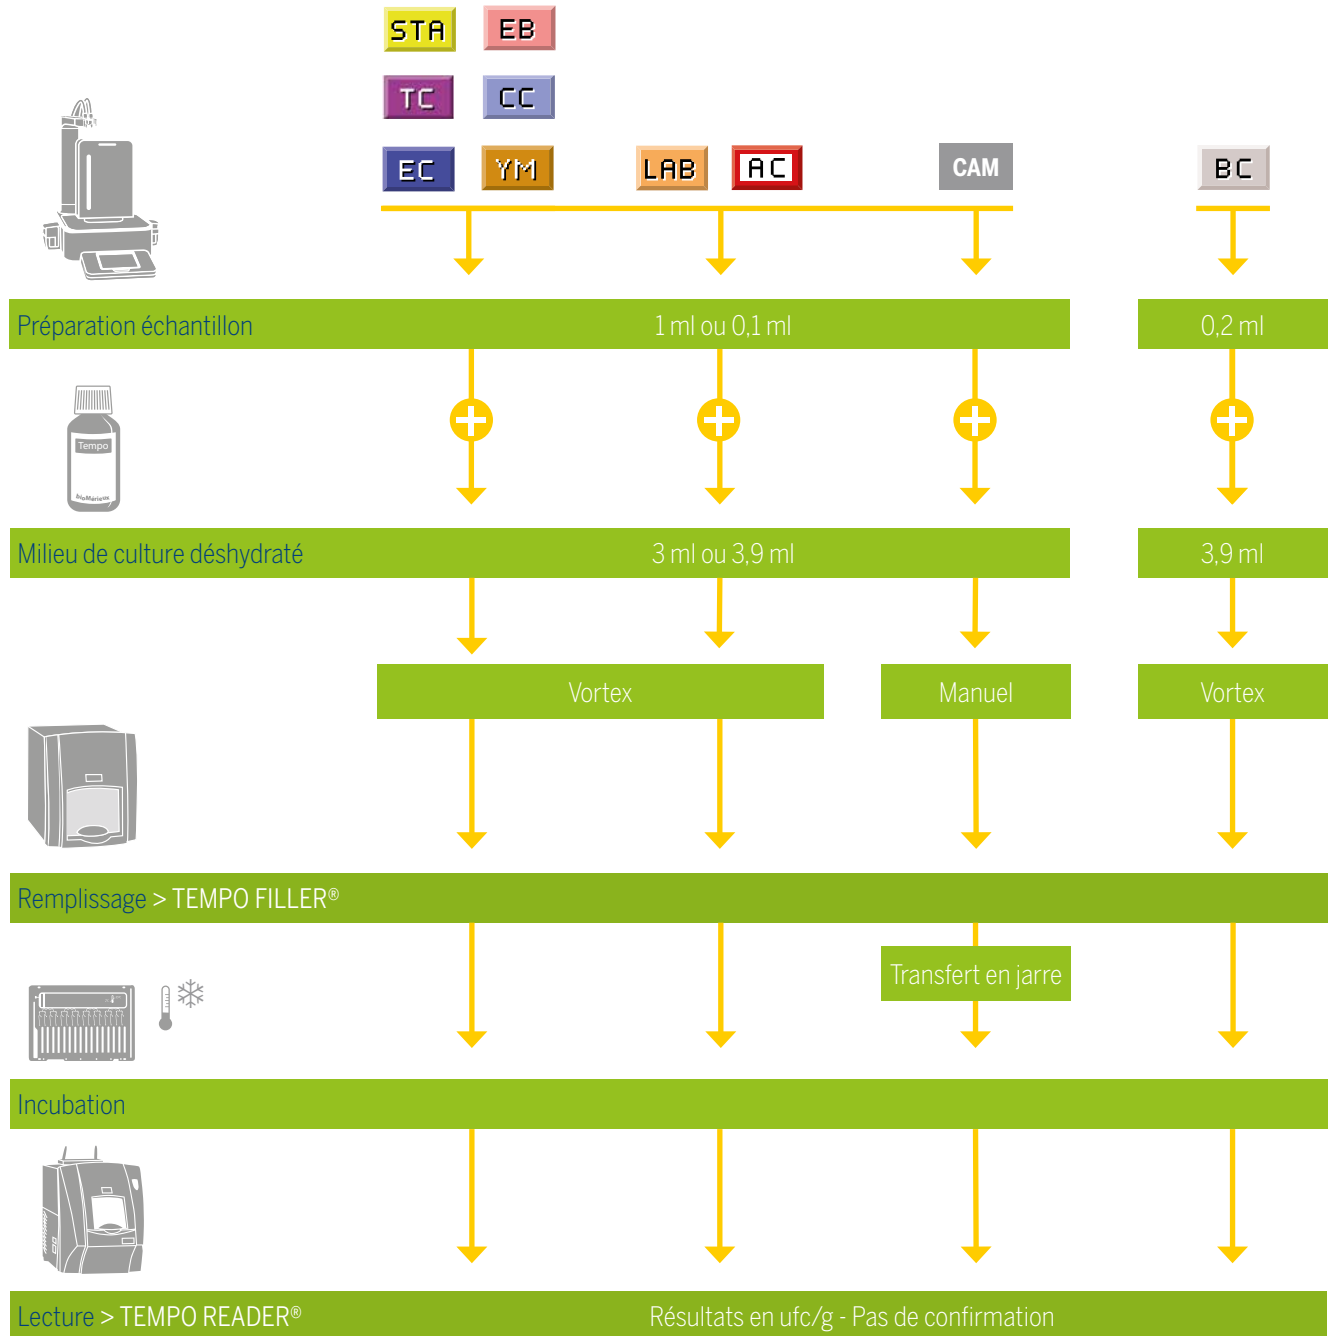

❄ Réfrigération avant ou après incubation en fonction du type de carte. Se référer à la fiche technique.

12-19 / 9318080 006/FR/A © bioMérieux • Ce document n'est pas juridiquement contraignant. bioMérieux se réserve le droit de modifier des spécifications sans préavis. BIOMÉRIEUX, le logo BIOMÉRIEUX, TEMPO READER et TEMPO FILLER sont des marques utilisées, déposées et/ou enregistrées appartenant à bioMérieux, ou à l'une de ses filiales ou à l'une de ses sociétés. ATCC est une marque de commerce et un nom ainsi que toutes les autres références catalogue ATCC qui appartiennent à American Type Culture Collection. Les autres marques et noms de produits mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs. bioMérieux SA RCS 673 620 399 RCS Lyon. • Photos: bioMérieux • bioMérieux S.A. RCS Lyon 673 620 399 • Imprimé en France par Masson Communication 438831927 RCS Saint-Malo